

Zeitschrift: Archives des sciences [1948-1980]
Herausgeber: Société de Physique et d'Histoire Naturelle de Genève
Band: 13 (1960)
Heft: 9: Colloque Ampère

Artikel: Modulation haute fréquence en résonance magnétique électronique
Autor: Theobald, J.-G. / Uebersfeld, J.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-738594>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 01.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Modulation haute fréquence en résonance magnétique électronique

par J.-G. THEOBALD et J. UEBERSFELD

Faculté des Sciences de Besançon

Résumé.

On décrit un dispositif de modulation haute fréquence permettant en particulier d'améliorer le rapport signal/bruit en résonance magnétique électronique tout en bénéficiant de l'observation oscillographique.

PRINCIPE ET INTERÊT DE LA MÉTHODE.

On se propose de moduler en haute fréquence un signal de résonance magnétique électronique en vue d'augmenter la sensibilité d'un spectromètre. On sait en effet que la puissance de bruit d'un cristal croît comme l'inverse de la fréquence, on peut donc espérer réduire considérablement le bruit du cristal en modulant à une fréquence élevée comprise entre 100 kHz et 1 MHz.

Le balayage à des fréquences élevées permet d'autre part d'étudier des effets de passage rapide en résonance magnétique électronique à température ordinaire, et de mesurer les temps de relaxation de l'ordre de 1μ seconde ou supérieurs, par exemple sur des charbons ou des substances irradiées.

La méthode consiste à introduire une bobine à l'intérieur de la cavité du spectromètre, ce qui permet en éliminant l'effet de peau et les courants de Foucault à travers la paroi de la cavité, de produire un champ de balayage relativement intense à une fréquence élevée.

DESCRIPTION DE L'APPAREILLAGE UTILISÉ.

Le spectromètre utilisé est un spectromètre à réflexion et coupleur directif muni d'un balayage à 50 périodes pour la présentation oscillographique.

Le champ de balayage haute fréquence est produit par une petite bobine rectangulaire placée à l'intérieur de la cavité cylindrique TE_{011} . Cette bobine a une longueur égale à la hauteur de la cavité et les grands côtés de la bobine sont rendus soigneusement parallèles à l'axe de la cavité pour respecter les conditions d'orthogonalité du champ électrique et des conducteurs. Les petits côtés sont parallèles aux fonds de la cavité et le plus près possible de ceux-ci pour que les angles soient dans des régions de champ électrique faible. On améliore encore les résultats en donnant aux grands côtés une longueur légèrement supérieure à la hauteur de la cavité et en évitant en leur centre les fonds de la cavité.

Les caractéristiques de la bobine sont les suivantes :

- 30 spires de fil émaillé de 15/100 mm de diamètre;
- longueur d'une spire: 50 mm;
- largeur: 4mm.


L'impédance a été étudiée en fonction de la fréquence. Elle vaut 210 ohms à 1 MHz. Ces données permettent de calculer le champ créé au centre de la bobine, soit 60 gauss par ampère parcourant la bobine. La bobine est alimentée par un amplificateur de puissance accordable piloté par un générateur. On atteint une amplitude de balayage de 40 gauss à 1 MHz.

Le dispositif utilisé n'affecte que dans des limites raisonnables la surtension de la cavité. Celle-ci est diminuée environ de 25% et reste supérieure à 4.000 (cavité adaptée au guide).

OBSERVATION DE SIGNAL EN DOUBLE BALAYAGE.

On applique en même temps que le champ de balayage à 50 Hz d'amplitude supérieure à la largeur de raie, un champ de balayage HF d'amplitude inférieure à la largeur de raie. Cette double modulation a pour effet de tracer automatiquement sur l'écran d'un oscillographe la dérivée de la courbe d'absorption de résonance magnétique électronique si la détection de la haute fréquence conserve la phase. Nous avons utilisé soit un amplificateur accordé suivi d'un détecteur synchrone, soit un récepteur superhétérodyne; dans les deux cas nous avons obtenu des résultats analogues. Le gain en sensibilité par rapport à la présentation oscillographique normale (balayage large à 50 Hz) est de 10 à une fréquence de modulation de 100 kHz et de 30 à une fréquence de modulation de 1 Mhz, conformément aux prévisions théoriques.

Par ailleurs la microphonie du spectromètre est considérablement réduite et pratiquement supprimée.

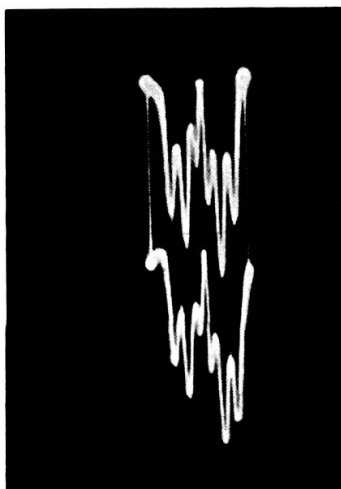

Sur la figure on a montré la structure hyperfine du DPPH en solution
 $\frac{1000}{M}$ (signal détecté en amplitude).
