

Zeitschrift: Physiotherapeut : Zeitschrift des Schweizerischen
Physiotherapeutenverbandes = Physiothérapeute : bulletin de la
Fédération Suisse des Physiothérapeutes = Fisioterapista : bollettino
della Federazione Svizzera dei Fisioterapisti

Herausgeber: Schweizerischer Physiotherapeuten-Verband

Band: - (1981)

Heft: 3

Titelseiten

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)


Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 14.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

FSP
SPV
FSF

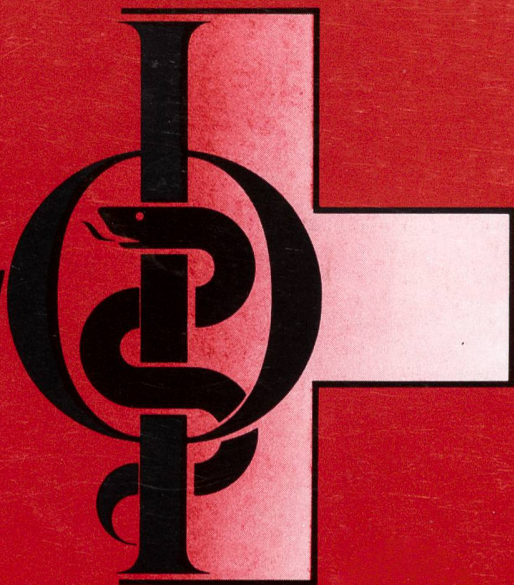

FÉDÉRATION SUISSE DES PHYSIOTHÉRAPEUTES
SCHWEIZERISCHER PHYSIOTHERAPEUTENVERBAND
FEDERAZIONE SVIZZERA DEI FISIOTERAPISTI

No. 3 / JUNI 1981

**DER PHYSIOTHERAPEUT
LE PHYSIOTHÉRAPEUTE
IL FISIOTERAPISTA**

L'électrothérapie de l'avant-garde

A la pointe de la technique les nouveaux
appareils de thérapie par ultra-sons et
basses fréquences d'Enraf-Nonius


Dynapuls 424 Sonopuls 417

Dynapuls 424


- indication digitale d'intensité
- horloge digitale
- courants:
 - galvanique
 - 4 Diadynamiques
 - cp isodynamique
 - rythme syncopé
 - courant de Träbert
- mélange base galvanique avec diadynamiques

Sonopuls 417

- tête de traitement légère et maniable avec contrôle de contact
- émission continue et 3 possibilités de fréquences pulsées
- horloge digitale en relation avec le contrôle de contact
- connexion possible avec tous types d'appareils basses et moyennes fréquences
- instrument de mesure de l'intensité

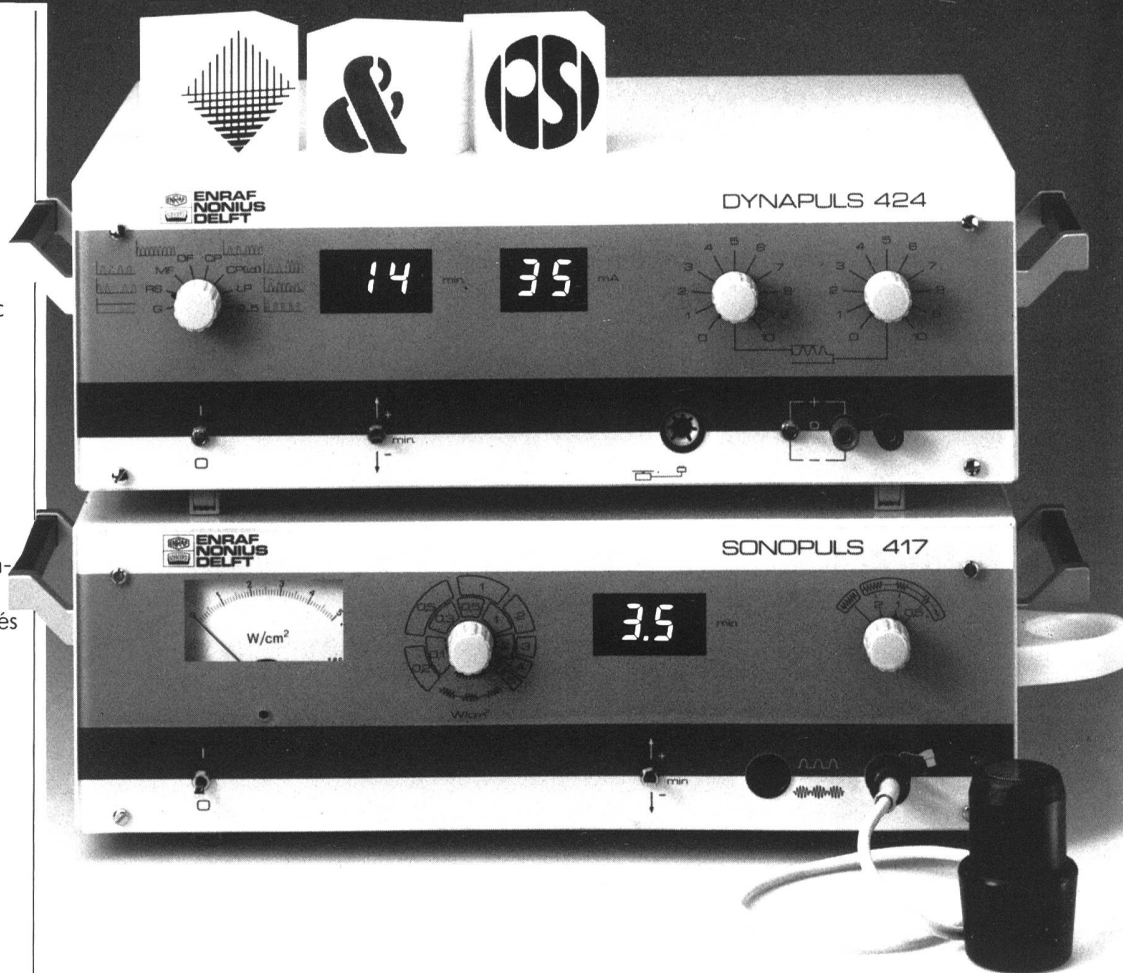

Fango Co GmbH
Fischmarktplatz 9
CH-8640 Rapperswil
Tel. 055 27 8877



Einrichtungen
für die
Physiotherapie



Physio-Service SA
Route de Crissier 32
CH-1023 Crissier
Tél. 021 35 24 61

**Votre
partenaire
pour
la physiothérapie**